



DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AVENIDA ADÃO WELKER, 104
BARÃO DE COTEGIPE – RS CEP:99.740-000
CNPJ:08.117.149/0001-67
INSC.EST:170/0008096
FONE/FAX:(54)3523-2407
maxi@maxihospitalar.com.br

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°71/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

A MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.117.149-0001-67, estabelecida na Av: Adão Welker nº 104, Bairro: Centro - Barão de Cotegipe - RS, por sua Sócia Gerente Sra Denise Cima Szymanski, portador da carteira de identidade RG n.º 1.076.888-419 e CPF nº 969.379.980-15, vem, mui respeitosamente e tempestivamente, à honrosa presença de V. Exa., com base na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, apresentar à Comissão de Licitação e ao Sr. Pregoeiro o presente RECURSO AOS ITENS 20,23,56 DO PREGÃO PRESENCIAL SUPRACITADA:

Pelos seguintes fundamentos de fato e de direito:

I - DOS FATOS

A atual arrematante e demais empresas que foram classificadas para a etapa de lances, cotaram marcas as quais não contemplam o descritivo do item nº20 solicitado neste Edital, conforme será demonstrado abaixo.

Solicitação do Edital:

"Aparelho Otoscópio com cabo em metal cromado inoxidável para 02 (duas) pilhas médias comuns (não inclusas), revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura. Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade, visor móvel, lâmpada incandescente de 2,5 V. Com 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável."

A Marca MD cotada pela empresa arrematadora Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, esta marca não atende o descritivo solicitado, pois o material do mesmo não é aço inoxidável e sim de material acetinado e não possui capa antiderrapante para melhor empunhadura, também os espéculos são com encaixe, no descritivo está pedindo sem encaixe, conforme segue catálogos para sua apreciação.



DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AVENIDA ADÃO WELKER, 104
BARÃO DE COTEGIPE – RS CEP:99.740-000
CNPJ:08.117.149/0001-67
INSC.EST:170/0008096
FONE/FAX:(54)3523-2407
maxi@maxihospitalar.com.br

Sendo que cotamos um equipamento que contempla 100% o descritivo solicitado e não nos classificamos para a fase de lances, conforme segue catálogo para sua apreciação.

Referente ao Item nº23:

Solicitação do Edital:

"Aparelho para verificação arterial adulto. Possui mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, **braçadeira em tecido de algodão e fecho em metal**, perâ com válvula em metal reforçado."

A Marca Solidor cotada pela empresa arrematadora Plasmedic Comércio de Materiais para Uso Médico e Hospitalar, Solidor e Premium não atendem o descritivo solicitado, pois conforme o material dos mesmos não são com braçadeira em tecido de algodão e fecho em metal e sim braçadeira em nylon e fecho em metal, estas marcas apenas comercializam braçadeiras em algodão fecho em velcro ou nylon com fecho em metal, conforme segue catálogos para sua apreciação.

Sendo que cotamos um equipamento que contempla 100% o descritivo solicitado e não nos classificamos para a fase de lances, conforme segue catálogo para sua apreciação.

Referente ao Item nº56:

Solicitação do Edital:

"**Cilindro de alumínio** para oxigênio, com capacidade (litros/m3): 07 litros/1m3. Cilindro pintado na cor verde conforme norma de identificação de gases da ABNT."

A marca cotada Mat Incendio pela empresa arrematadora Olimed Material Hospitalar Ltda, não fabrica Cilindro de Alumínio somente em Aço Carbono, não atendendo ao descritivo solicitado.

Sendo que cotamos um equipamento que contempla 100% o descritivo solicitado e não nos classificamos para a fase de lances, conforme segue catálogo para sua apreciação.

Diante do exposto, a ora recorrente requer a desclassificação das arrematantes dos Itens 20,23,56, vez que a mesma apresenta desconformidades em relação às especificações técnicas solicitadas em edital.

Cabe salientar que o edital é soberano conforme previsto em lei, nos termos do Art.41 da Lei 8.666/93:

Art.41 "A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada".



DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AVENIDA ADÃO WELKER, 104
BARÃO DE COTEGIPE – RS CEP:99.740-000
CNPJ:08.117.149/0001-67
INSC.EST:170/0008096
FONE/FAX:(54)3523-2407
maxi@maxihospitalar.com.br

No sábio dizer do consagrado Hely Lopes Meirelles, "o edital é a lei interna da licitação, condicionando todo o desenvolvimento do certame e até mesmo o futuro contrato".

Logo, prevista em edital a exigência das especificações que devem estar presentes no equipamento, não pode a Administrar Pública afastar-se do que foi pré-estabelecido pela própria Administração.

Ainda que o lote tenha sido declarado vencedor ou adjudicado à empresa arrematante, a licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é passível de anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da lei 8.666, de 1993, aplicável ao pregão por força do art. 9º da Lei 10.520/2002, e da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que dispõem:

Lei 8.666, de 1993:

"Art.49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado".

Súmula nº 473:

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando, eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em todos os casos, a apreciação judicial". (grifo acrescentado).

Portanto, ainda que homologada a licitação, a Administração Pública está autorizada a anular o procedimento licitatório, quando verificada a existência de alguma ilegalidade, e revogá-lo, por razões de interesse público superveniente.

II - DO PEDIDO

Não obstante reconhecida e admitida à competência e notório saber jurídico do Senhor Pregoeiro bem como da Equipe Técnica, *data venia*, a recorrente requer a reforma da Decisão que classificou como vencedoras as empresas licitantes do Pregão em epígrafe para os itens acima citados, procedendo à desclassificação das licitantes por descumprir as exigências editalícias, conforme supra exposto.

Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso na íntegra, para no mérito, dar-lhe provimento.

Termos em que pede e aguarda deferimento, por ser esta medida pura e cristalina de justiça!



DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AVENIDA ADÃO WELKER, 104
BARÃO DE COTEGIPE – RS CEP:99.740-000
CNPJ:08.117.149/0001-67
INSC. EST:170/0008096
FONE/FAX:(54)3523-2407
maxi@maxihospitalar.com.br

Barão de Cotegipe - RS, 24 de Julho de 2014

P.P. Elaine Biedacha

Elaine Biedacha
CPF: 005.576.880-60



DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AVENIDA ADÃO WELKER, 104
BARÃO DE COTEGIPE - RS CEP:99.740-000
CNPJ:08.117.149/0001-67
INSC. EST:170/0008096
FONE/FAX:(54)3523-2407
maxi@maxihospitalar.com.br

PROCURAÇÃO



Outorgante: Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Barão de Cotegipe - RS, sito Avenida Adão Welker, 104, inscrita no Cnpj/ME: 08.117.149/0001-67 e Inscrição Estadual nº 170/0008096, neste ato representado pelo sócio gerente **Denise Cima Szymanski**, portador da carteira identidade nº 1076888419 e Cpf nº 969.379.980-15, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Jose Bonifacio, 636, na cidade de Barão de Cotegipe- RS.

Outorgado: Elaine Biedacha, portador do RG nº 5087942495 e CPF nº. 005.576.880-80.


Poderes: representar a outorgante nos processos licitatório, podendo efetuar cadastro, retirar editais, formular ofertas, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recursos, retificar a própria proposta de preços, participar de reuniões, examinar e visar documentos e propostas de preços, **assinar propostas, atas e contratos**, recorrer e praticar todos os atos necessários em implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho da empresa MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Barão de Cotegipe - RS, 02 de Junho de 2014.

Está procuração tem validade até 31 de Julho de 2014.

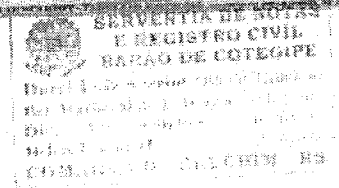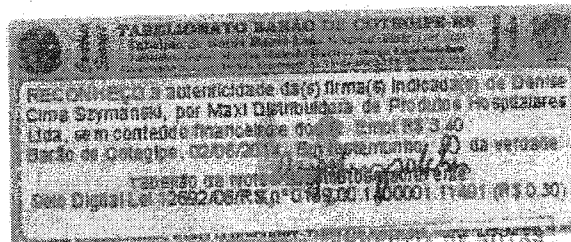

Denise Cima Szymanski
DENISE CIMA SZYMANSKI
SÓCIA-GERENTE
CPF: 969.379.980-15
RG: 1076888419

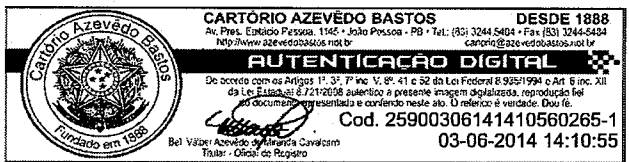

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.

O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 04/06/2014 às 10:45:54 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7cf534716e3946f7869da9006076e172e9e92eb4fabd7e2bcd5978dd8f659e467876acb66640bad41f1e1371ef30c180934dd019f4ddfdd9676bd5d51aa3ba86

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para MAXI DIST. PROD. HOSP. LTDA e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 03/06/2015 às 16:16:09 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 256381

Código de Controle da Autenticação:


25900306141410560265-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>





OTOSCÓPIO TK REF: 007

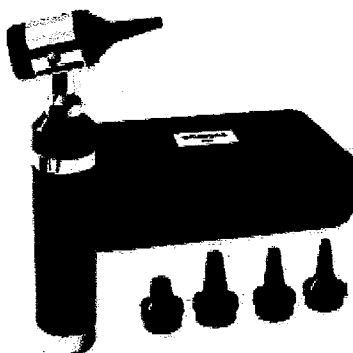


OTOSCÓPIO TK REF: 007

- Otoscópio com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas médias comuns, recoberto por capa antiderrapante de punho
 - Cabecote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade
 - Visor movel
 - Lâmpada incandescente de 2,5 V. Ref L-07
 - 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades
 - 01 espéculo de diâmetro 2,8 mm N° 1
 - 01 espéculo de diâmetro 4,15 mm N° 2
 - 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm N° 3
 - 01 espéculo de diâmetro 6,0 mm N° 4
 - 01 espéculo de diâmetro 9,0 mm N° 5
- O APARELHO NÃO ACOMPANHA PILHAS

Mikatos Indústria Comércio e Serviços de Aparelhos Médicos Ltda.
Rua Koto Mitsutani, 75 - Jardim Mitsutani - São Paulo - CEP: 05791-000 - Fone: (11) 5842-1994 (fábrica)
Fone/Fax: (11) 4782-0278 (comercial) CNPJ: 05.030.501/0001-34 INSC. EST: 116.386.048.112

Otoscópio Mark II

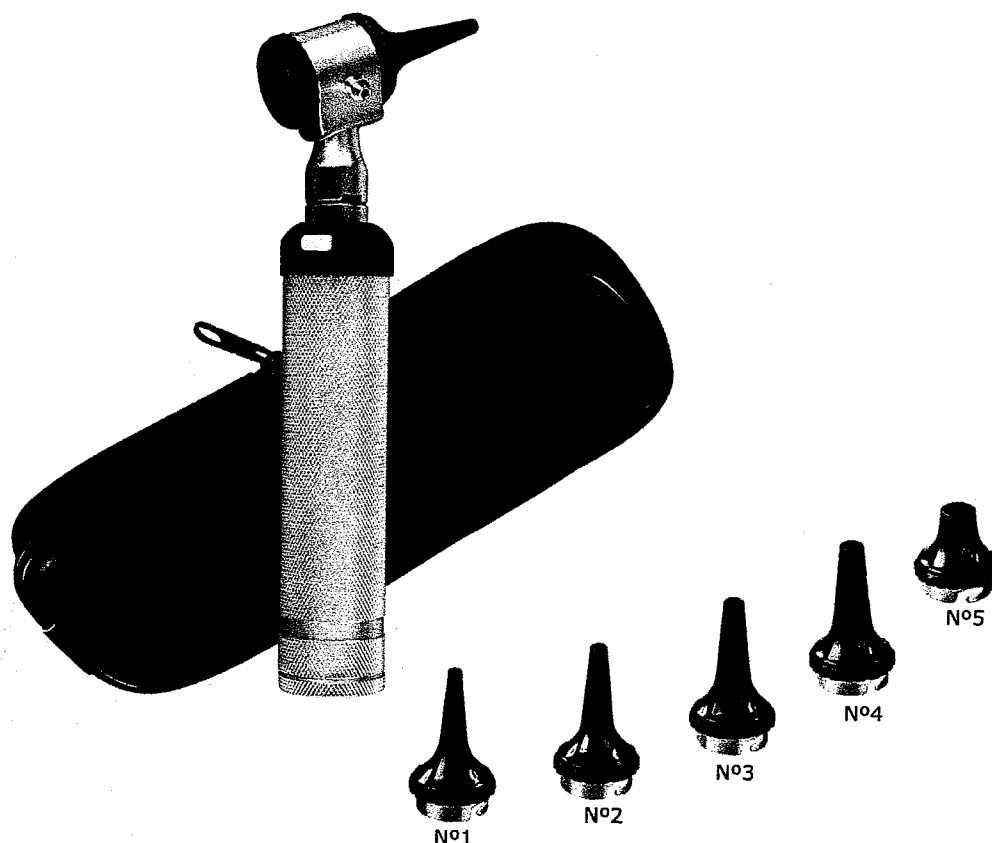

- Lâmpada de Halogênio Xenon
- Conexão para otoscopia pneumática
- Lente giratória com aumento de 4 vezes
- Controle da intensidade da luz e liga/desliga
- Espéculos de ouvido autoclaváveis ou descartáveis
- Cabo recartilhado com acabamento acetinado
- Acompanha prático estojo com compartimentos
- Transmissão da luz de forma direta

Especulo Reutilizável

Especulo Nº. 1	2.5mm
Especulo Nº. 2	3.5mm
Especulo Nº. 3	4.5mm
Especulo Nº. 4	5.5mm
Especulo Nº. 5	9.0mm


Fabricante
Medical Devices (Pvt) Ltd.
Wazirabad Road
Ugoki, Sialkot
Paquistão

Importador
Macrosul Ltda
macrosul@macrosul.com
Curitiba - Paraná
Brasil

Distribuidor autorizado

Esfigmomanômetro P.A. MED

- Manguito e pera anatômica de alta durabilidade
- Válvula para perfeita retenção de ar e medição
- Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300 mmHg
- Braçadeira 100% algodão ou nylon com tratamento impermeável, com fecho em velcro duplo ou metal
- Rigorosamente testado pelo Controle de Qualidade CBEMED
- Manômetro aferido individualmente pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo Inmetro com 100% de garantia de inspeção
- Registrado na ANVISA - MS 80540449001

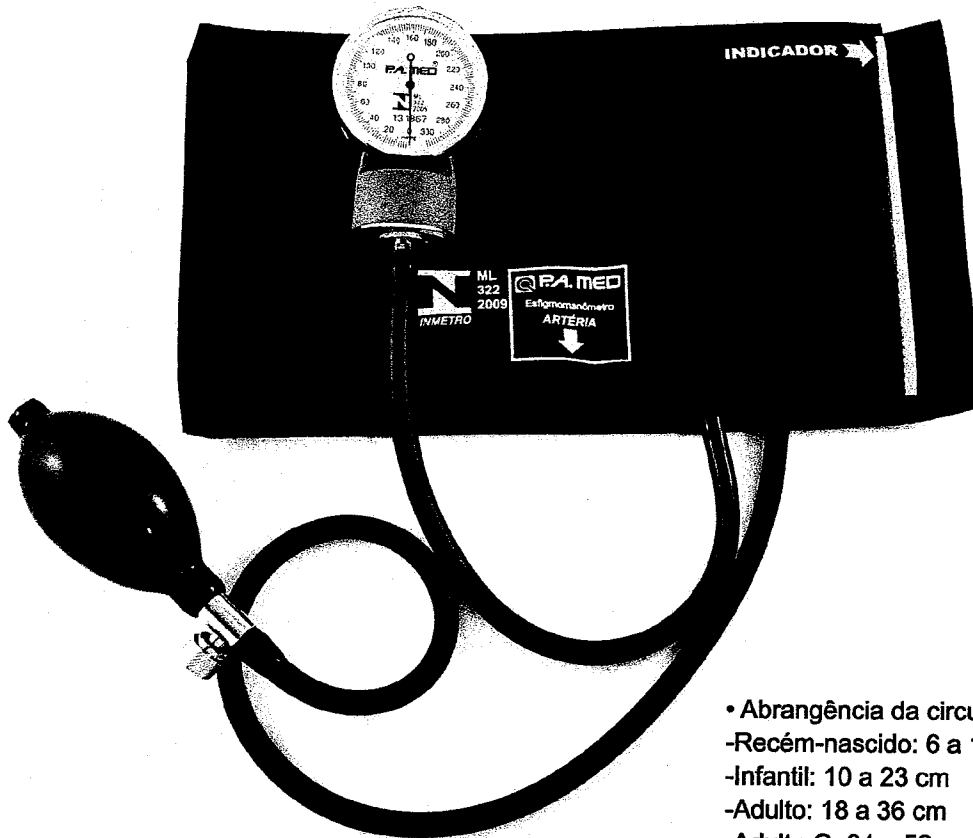

2*
anos de
garantia

- Abrangência da circunferência de braço:
 - Recém-nascido: 6 a 15 cm
 - Infantil: 10 a 23 cm
 - Adulto: 18 a 36 cm
 - Adulto G: 34 a 52 cm


- Cores disponíveis para o modelo nylon velcro adulto:



- Para os tamanhos recém-nascido, infantil, e adulto G somente disponíveis no modelo nylon velcro cinza



Acompanha estojo prático e ergonômico na cor preta

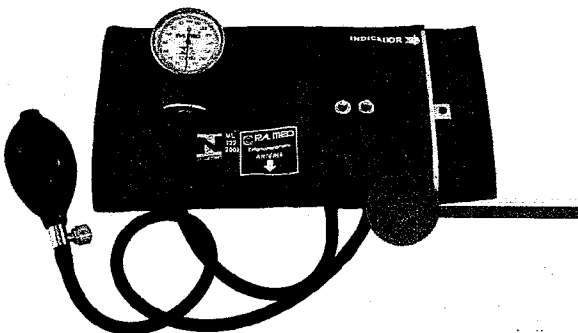

Braçadeira na cor cinza para os modelos 100% algodão ou nylon com fecho em metal

* Exceto braçadeiras - 1 ano de garantia



Lamedid Comercial e Serviços Ltda.

ESFIGMOMANÔMETRO - Aneróide

Marca: **SOLIDOR**®
 Procedência: China
 Reg.MS: 10237580015


Características técnicas:

Utilizado para medir a pressão arterial sanguínea em seres humanos.

- Manual, tipo aneróide, leve e portátil.
- Certificado de aferição e aprovação do INMETRO-IPEM/SP

Material:

Tipo	Braçadeira	Modelo
Aneróide	Velcro	Adulto
Aneróide	Metal	Adulto

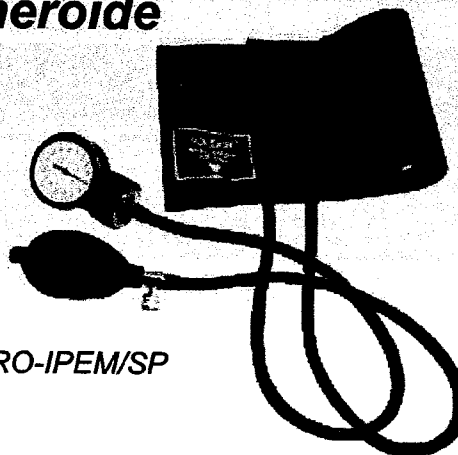

Manômetro aneróide

Faixa de medição de 0 a 300 mmHg
 Menor divisão 2 mm de Hg.

Braçadeira - Confeccionada em **NYLON**

Ajustável ao braço e fixada por fecho de **Velcro** ou **Metal**.
 Destinada a braços com perímetro de 22 a 28 cm.
 Dotada de uma tira para fixação do manômetro e seta indicadora, para o correto posicionamento sobre a artéria.

Manguito

Confeccionado em latex, com dois tubos vulcanizados do mesmo material.

Pera

Confeccionada em latex, com formato anatômico e flexível.

Válvula de Controle de Ar

Confeccionada em metal cromado e botão de regulação manual.

Benefícios:

Acompanha estojo em couro sintético.


Garantia de 06 meses a contar da data da compra.

Aprovado pela portaria do INMETRO nº 35 de 22 de abril de 1999 e nº 143 de 23 de agosto de 2002.

Embalagem: Caixa com uma 01 unidade.

ACCUMED GLICOMED

Esfigmomanômetro Aneróide Premium

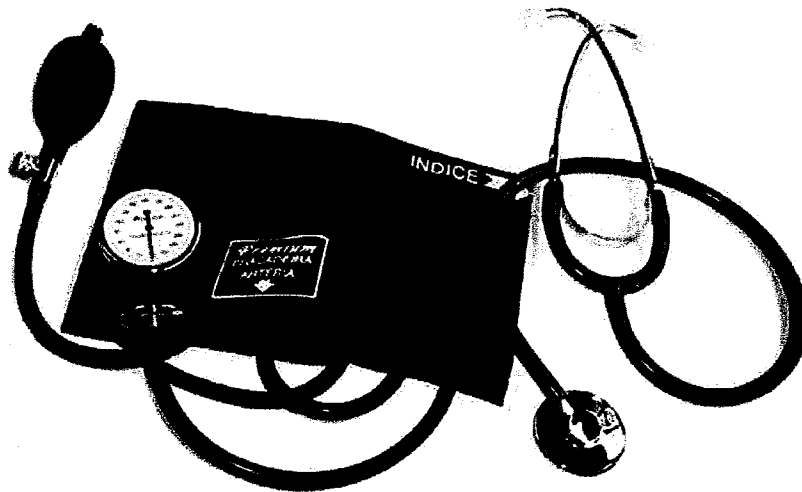

Descrição do produto

- Verificado e aprovado pelo INMETRO
- Apresentação Neo Natal, Infantil, Adulto e Obeso
 - Manguito com pêra em PVC
- Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro
 - Braçadeira em nylon com fecho metal
- Braçadeira em 7 diferentes cores: azul marinho, azul, verde, vermelho, grafite, rosa e vinho
- Estojo para viagem

■ ■ ■ Cilindro para gases

Código	Descrição
005320	CILINDRO EM ALUMÍNIO TIPO D 3 lts - VAZIO (7)
005321	CILINDRO EM ALUMÍNIO TIPO E 5 lts - VAZIO (8)
003638	CILINDRO EM AÇO 7 lts - VAZIO (4)
003639	CILINDRO EM AÇO 10 lts - VAZIO (2)
003640	CILINDRO EM AÇO 15 lts - VAZIO (3)
003643	CILINDRO EM AÇO 20 lts - VAZIO (4)
003641	CILINDRO EM AÇO 40 lts - VAZIO (5)
003642	CILINDRO EM AÇO 50 lts - VAZIO (6)

■ FINALIDADE

Armazenamento de gases.

■ CARACTERÍSTICAS

Confeccionado em aço (Pressão de trabalho de 200BAR)


Confeccionados em alumínio (Pressão de trabalho de 150BAR).

■ COMPOSIÇÃO

Cilindro acompanhado de válvulas RTO.

■ OFEREÇA TAMBÉM

Válvulas reguladoras, fluxômetros.

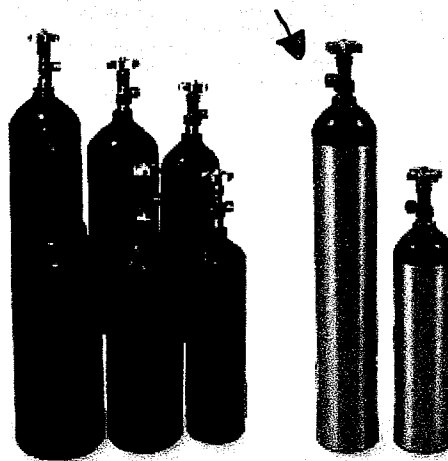

■ ■ ■ Carrinhos para transporte de Cilindros


Código	Descrição
003537	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO 20 lts (1)
003534	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO 3 lts (2)
003535	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO 5 lts (2)
003536	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO 7 e 10 lts (2)
003538	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO 50 lts (3)

■ FINALIDADE

Transportar Cilindros.

■ CARACTERÍSTICAS

Confeccionado em aço com pintura eletrostática e tratamento anti-ferrugem. Rodízios de borracha.

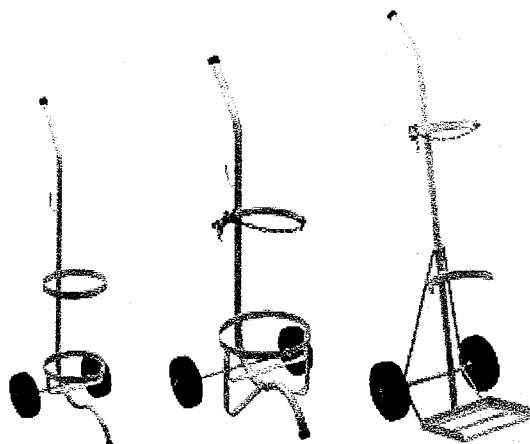

LTS = Litros (Capacidade Hidráulica)



Linha dos produtos
Línea de productos
Product line

Normas/Standard

ISO 4705D e ISO 9809-1

Gases do Ar/Gases del Aire/Industrial Gases

MODELO Modelo Type	CAPACIDADE DE ÁGUA Capacidad de agua Water capacity (l)	CAPACIDADE DE GÁS Capacidad de gas Gas capacity (m3)	DIAM. EXTERNO Diam. Ext. Out Side Diam. (mm)	COMPRIMENTO Largo Length (mm)	PESO Peso Weight (Kg)	PRESSÃO DE SERVIÇO Presion de Servicio Working Pressure (bar)
50.235	50,00	10,00	235,00	1390	55,0	200
40.219	40,00	8,00	219,10	1305	48,9	200
40.219a	40,00	6,00	219,10	1305	48,9	150
20.219	20,00	4,00	219,10	715	29,5	200
20.219a	20,00	3,00	219,10	715	29,5	150
16.177	16,00	2,40	177,80	790	17,6	150
10.165	10,00	1,50	165,10	630	14,5	150
07.165	7,00	1,00	165,10	470	11,5	150
05.139	5,00	0,75	139,70	440	6,6	150
3,6.139	3,60	0,54	139,70	400	5,0	150
03.114	3,00	0,45	114,30	420	5,5	150

CO² para Indústrias de Bebidas, de Alimentação, Uso Médico e Extintores
para Industrias de Gaseosas, de Alimentación, Uso Medicinal y Extinguidores
Soft Drinks Industries, Food, Medicinal Use and Extinguishers

MODELO Modelo Type	CAPACIDADE DE ÁGUA Capacidad de agua Water capacity (l)	CO ² (Kg) Gas capacity (m ³)	DIAM. EXTERNO Diam. Ext. Out Side Diam. (mm)	COMPRIMENTO Largo Length (mm)	PESO Peso Weight (Kg)	PRESSÃO DE SERVIÇO Presion de Servicio Working Pressure (bar)
67.273	67,00	45,00	273,00	1420	81,1	150
16.177	16,00	11,00	177,80	790	17,6	156,2
10.165	10,00	7,00	165,10	630	14,5	138,9
07.165	7,00	5,00	165,10	470	11,5	138,9
05.139	5,00	3,00	139,70	440	6,6	150
03.114	3,00	2,00	114,30	420	5,5	150

CLORO para Sistemas de Purificação de Água
para Sistemas de Purificación del Agua
Water Purification Systems

MODELO Modelo Type	CAPACIDADE DE ÁGUA Capacidad de agua Water capacity (l)	Cl (Kg)	DIAM. EXTERNO Diam. Ext. Out Side Diam. (mm)	COMPRIMENTO Largo Length (mm)	PESO Peso Weight (Kg)	PRESSÃO DE SERVIÇO Presion de Servicio Working Pressure (bar)
40.219	40,00	50,00	219,00	1305	48,9	33
55.273	55,00	69,00	273,00	1190	70,0	33

Medidas nominais/medidas nominales/nominal dimensions